




HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci  
Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: http://www.helago-cz.cz

**Destičky mikrotitrační, sterilní, PS,  
kulatý profil jamky**  
Objednací kód: **6331.600471800**

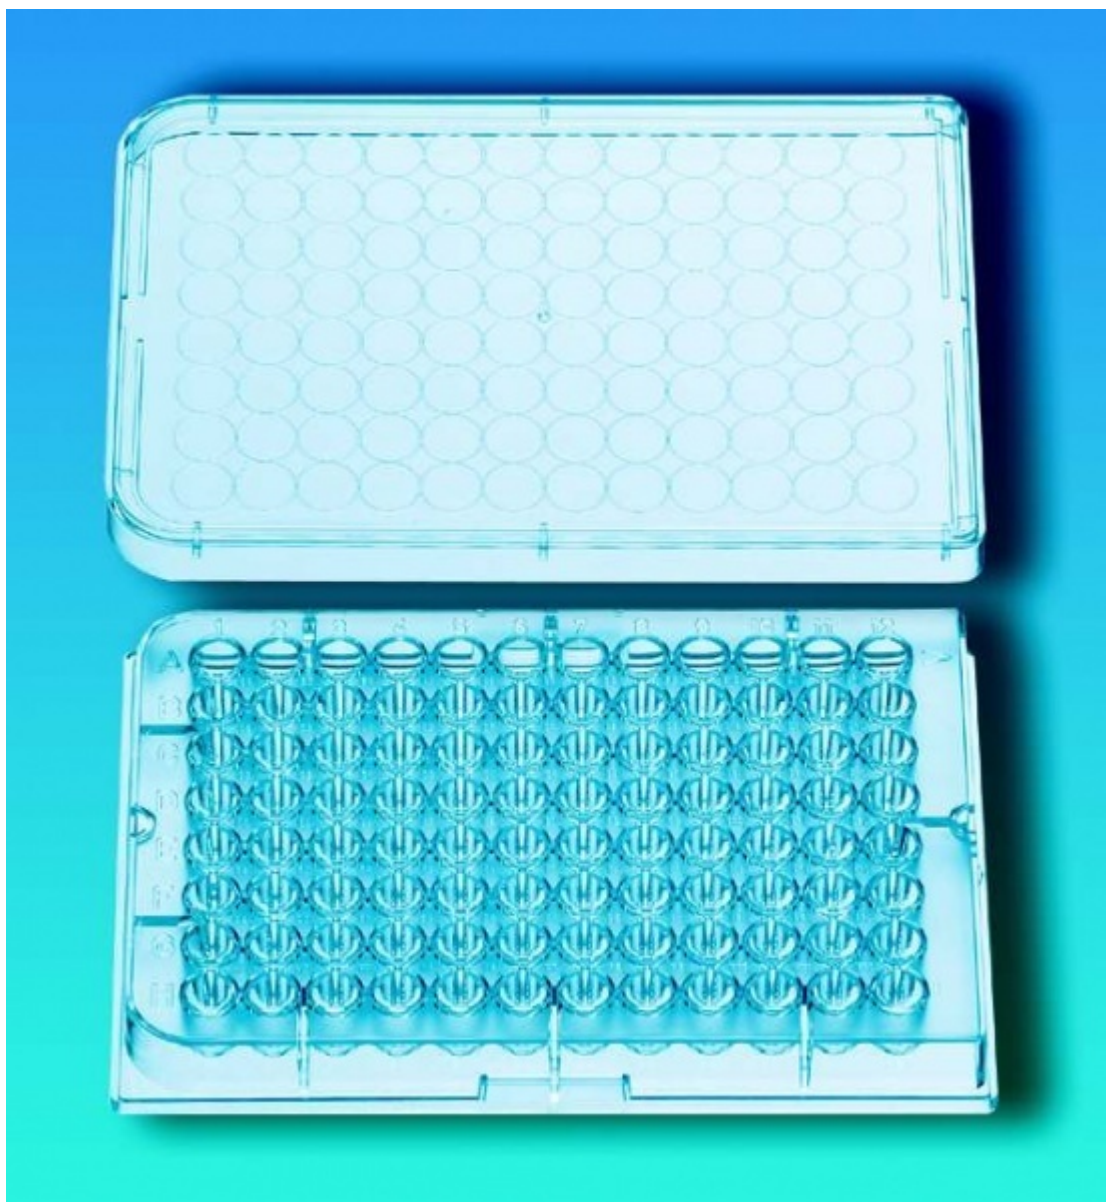

Cena bez DPH

1.740,00 Kč

Cena s DPH

2.105,40 Kč

Parametry

Balení [ks]

100

Typ (počet jamek)

96 U

Objem [ $\mu$ l]

345

Velikost balení

balení 100 ks

**Destičky mikrotitrační, 96 jamek, sterilní, PS**

96 jamek, křišťálově čisté, vynikající optická čitelnost, různé druhy jamek pro různé použití. Úchyty na bocích, snadná stohovatelnost. Speciální povrch víka zabraňuje průniku rušivého světla pro lepší práci se vzorky. Víko má označené rohy, aby nedocházelo k otočení a následné kontaminaci. Speciální kondenzační kroužky zabraňují ztrátám a vypařování média. Alfanumerické označení jamek pro snadnou identifikaci, prostor mezi jamkami pro dodatečné označování.

- U-jamky: bez okrajů - snadné čištění, pro +/- odhady, zvláště vhodné pro test aglutinace, maximální objem jamky 345  $\mu$ l
- V-jamky: zvláště vhodné pro vypuštění „poslední kapky“ z pipety, pro +/- odhad, vhodné pro skladování vzorků, maximální objem jamky 335  $\mu$ l
- F-jamky: pro precizní optická měření, pro mikroskopické použití (čtení přes dno), hrana na spodu jamky zabraňuje odření dna, maximální objem jamky 405  $\mu$ l