




HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

8000980 - Simulátor obrazovky pacientského monitoru Zoll® X Series®
pro REALITi360
Objednací kód: **4127.8000980**

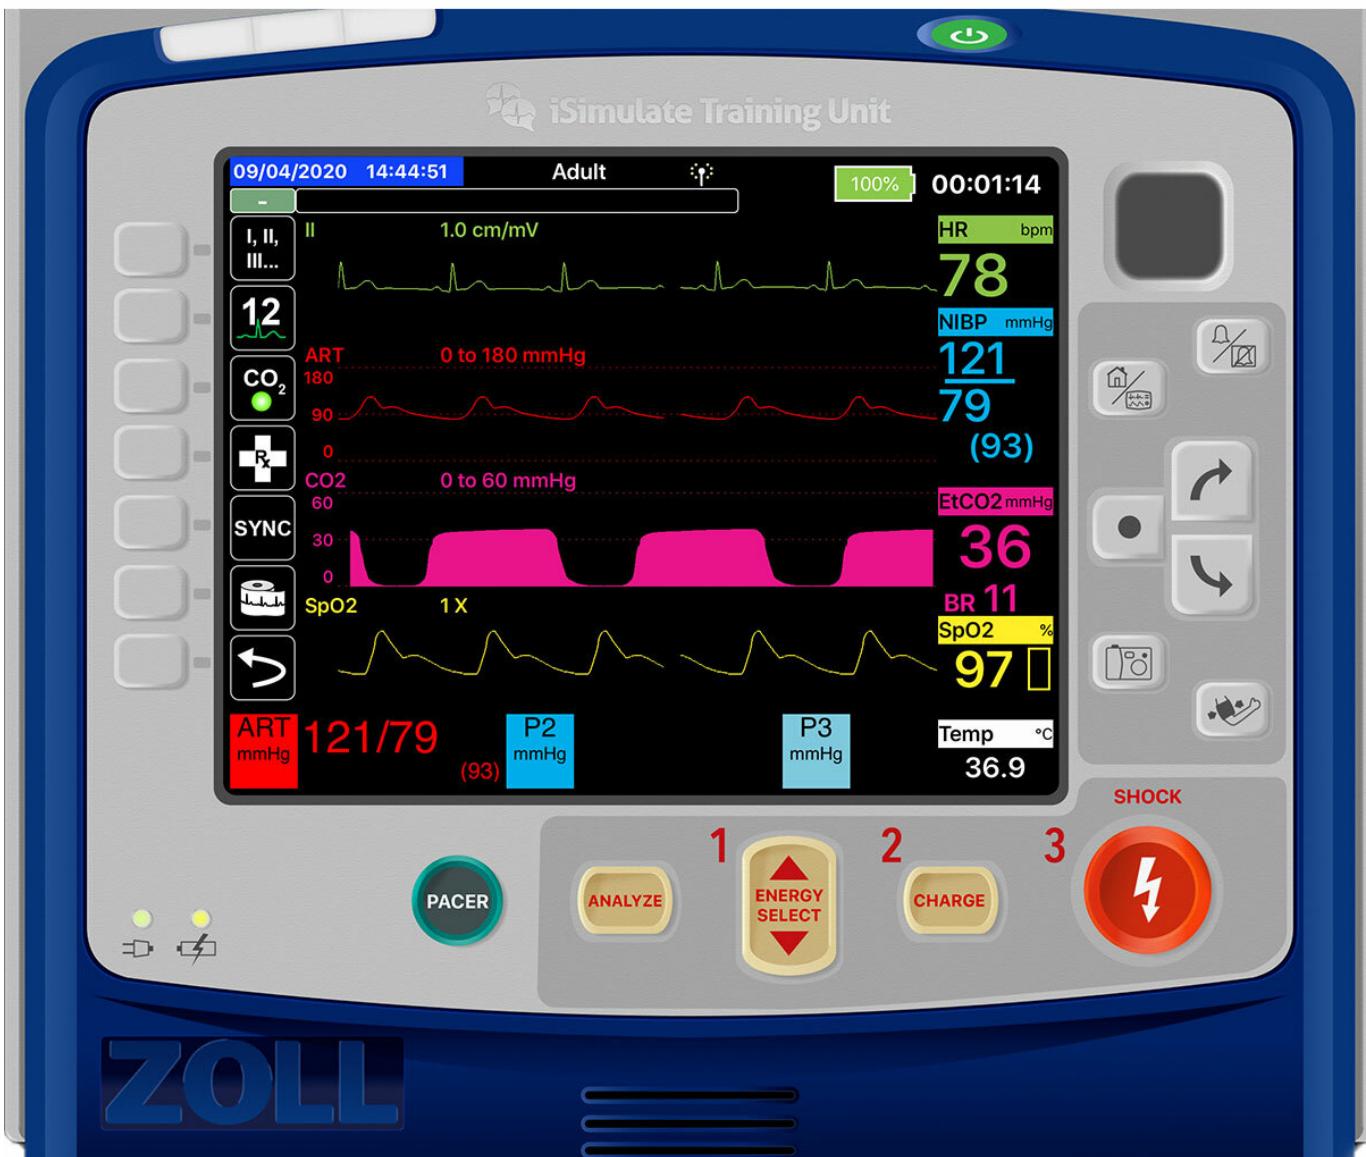

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Simulovaný pacientský monitor Zoll® série X je volitelně dostupnou obrazovkovou simulací prémiové značky, která funguje s aplikací pro monitor vitálních funkcí REALITi360 a defibrilátor. Simulovaný monitor je navržen pro používání se systémy pro simulaci pacientských monitorů REALITi Plus a REALITi Pro od iSimulate.

Instruktoři mohou snadno přidávat nácvikové scénáře nebo stahovat nové scénáře z platformy RELITi360 COMMUNITI.

REALITi360 obrazovky napodobují uživatelský interface pacientských monitorů a defibrilátorů několika známých výrobců. Díky spolupráci s předními výrobci vytvořil tým iSimulate vysoce realistická rozhraní, která vypadají a fungují jako skutečné monitory a defibrilátory, které se používají u skutečných zásahů. Současný a stále se rozšiřující výběr pacientských monitorů a defibrilátorů umožňuje studentům naučit se pracovat s mnoha různými monitory a defibrilátory, se kterými by se mohli setkat během své kariéry.

Na základě individuálních nácvikových potřeb a produktové konfigurace si mohou uživatelé vybrat jednu nebo více z těchto obrazovek a zařadit je do simulačního nácviku.

Simulace pacientského monitoru a defibrilátoru Zoll® série X dává uživatelům REALITi360 možnost trénovat KPR na vysoké úrovni, optimální defibrilaci a kardiostimulaci pro všechny stádia převozu kriticky nemocných novorozenců a dospělých pacientů. Tato obrazovková simulace perfektně napodobuje monitor Zoll® série X se všemi jeho příslušnými funkcemi.

Nutné příslušenství

- 4127.1022815 - Simulátor pacientského monitoru - REALITi Plus
- 4127.1022816 - Simulátor pacientského monitoru s debriefingem & CPR zpětnou vazbou - REALITi Pro

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytiskněn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko "Vytisknout".



Vytisknout!  Zobrazit vše